



# 抗生素类快速检测卡

## 抗生素类快速检测卡参数

### 产品简介

本产品为抗生素类胶体金快速检测卡，用于定性检测水产品等抗生素类残留，整个检测过程需约 30 分钟，检测限为 5-100ng/g(ppb)。

### 产品种类

磺胺类检测卡；氯霉素检测卡；孔雀石绿总量检测卡；替米考星检测卡

### 产品组成

抗生素类快速检测卡 ； 滴管 (1 个/袋)； 干燥剂 (1 片/袋)； 2×抗生素类卡样品稀释液(30ml/盒)

### 溶液配制

1×样品稀释液：

用去离子水将抗生素类卡样品稀释液按 1:1 体积进行稀释，待用。

### 样品处理

各项目不同，处理方法也不同

## 使用步骤


1. 在进行测试前先完整阅读使用说明书，使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温。
2. 从原包装袋中取出检测卡，打开后请在一个小时内尽快地使用。
3. 将检测卡平放，用移液器或滴管吸取待检样品溶液，垂直缓慢滴加 3 滴（约 80 $\mu$ l）于加样孔中，用时 30s-60s 滴加完毕，加样后开始计时。
4. 结果应在 10-15 分钟读取，其他时间判读无效，根据示意图判定结果。



## 结果判断

阴性(-)：C、T 线均清晰出现，表示样品中不含有毒素类或其浓度低于检测限。



阳性(+)：C 线出现，T 线不出现或若隐若无，则表示样品中毒素类浓度高于或等于检测限。

无 效：C 线不出现，表明操作过程不正确或检测卡已失效。

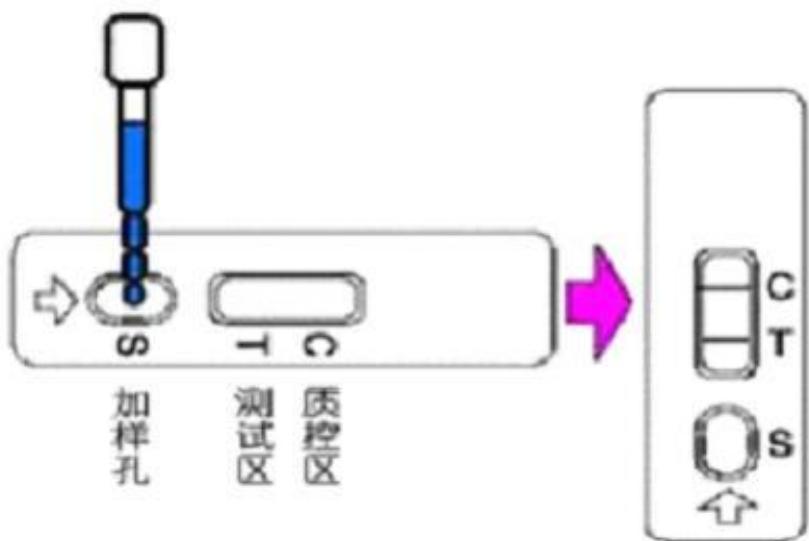

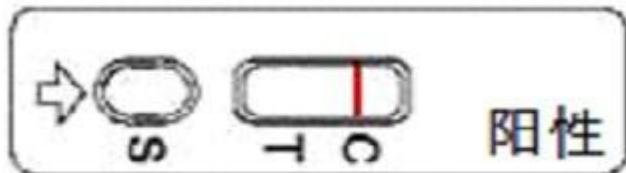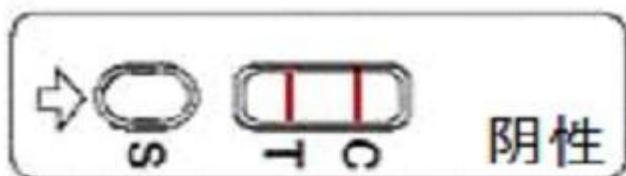

**以下两种情况无效**

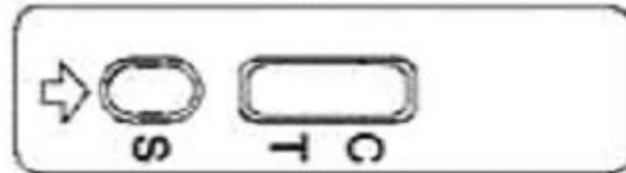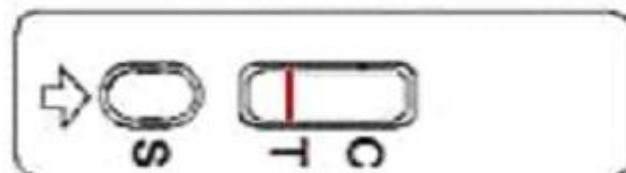

### 注意事项

1. 试验中所使用的水必须是去离子水或双蒸水，未列入的被检样本请致电技术服务。
2. 阳性结果时应按法定程序分瓶封装样品用于确证法检测；
3. 检测时避免阳光直射和电风扇直吹；
4. 尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面；
5. 滴管不可混用，以免交叉污染；
6. 试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

### 储存与有效期

原包装应储存于 4~25°C, 阴凉避光干燥处, 切勿冷冻。生产日期, 有效期及批号见外包装。



微信公众号



手机官网

### 企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com